


# Indicaciones para el tratamiento de cetonas con bomba y/o día de malestar

Si el nivel de glucosa o el sensor de glucosa en sangre es superior a 250 (al menos 2 horas después de la última comida) o si se siente mal, compruebe las cetonas y siga las instrucciones que se indican a continuación:

*\*Asegúrese de que la bomba esté en el **modo automático** antes de seguir las instrucciones que se indican a continuación\**

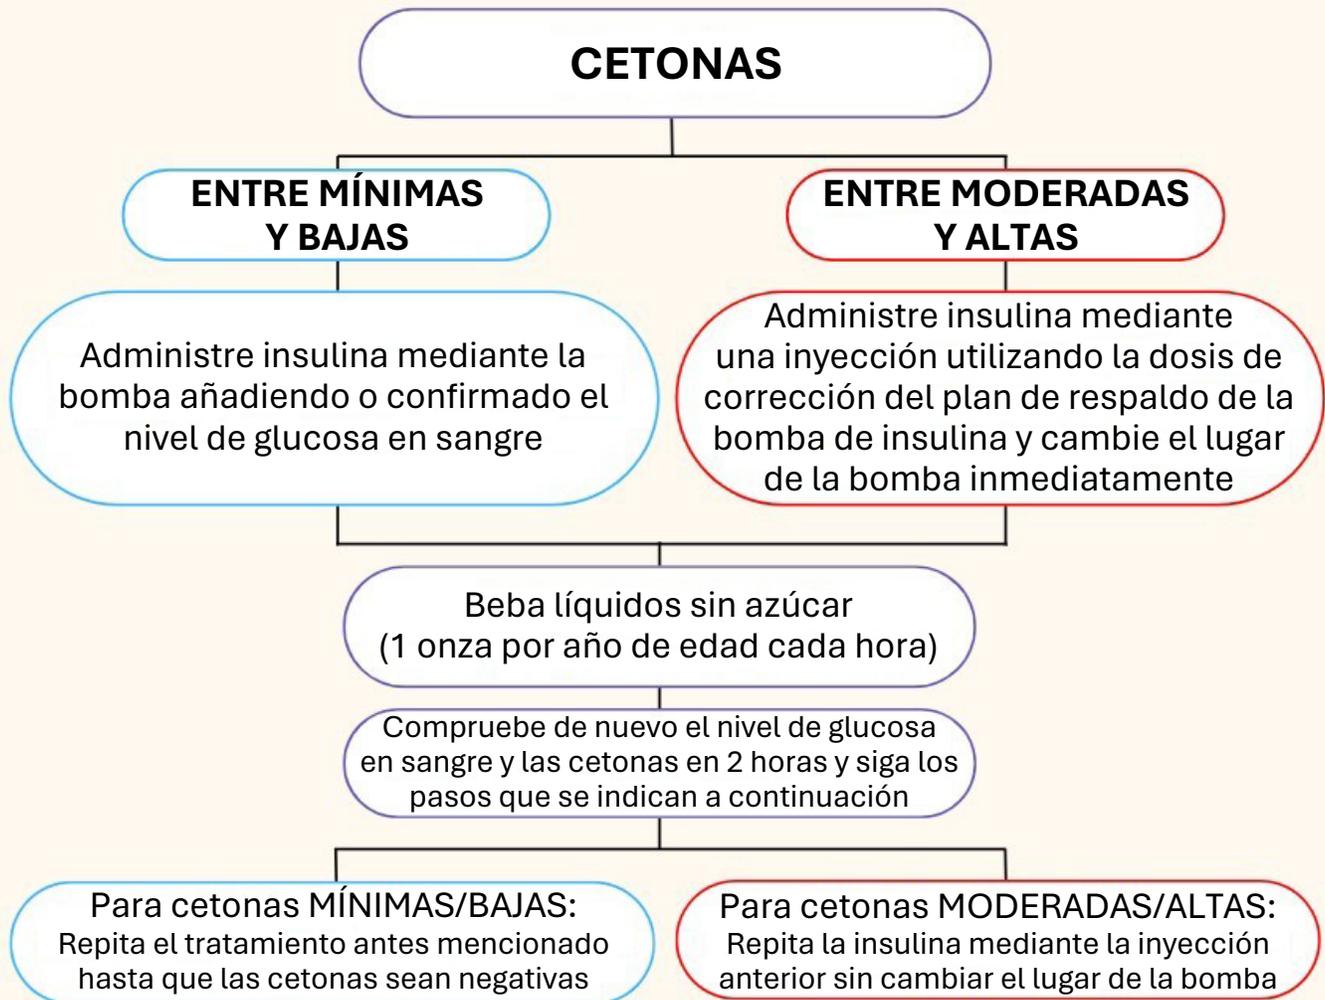

**Quando se sienta mal:** Continúe revisando las cetonas cada 4 horas, incluso si estas son negativas (cada 8 horas mientras duerme, si las cetonas son negativas)

## **Cuándo debe llamar a la línea de emergencias (901-287-6659)**

- Si necesita ayuda para activar el modo automático o si no puede usarlo.
- Si las cetonas no han mejorado después de 2 tratamientos.
- Si tiene vómitos, diarrea o problemas para comer o beber con las cetonas.
- Si el nivel de glucosa en sangre es inferior a 150 con cetonas.